Epsilon para: "Gepetto Mousse 3D"

ORTOIBÉRICA S.L.
Parque Tecnológico de Asturias – Parc. 1
33428 – Llanera –Asturias (España)
T:+34 985 79 48 00
welcome@ortoiberica.es
www.ORtoiberica.com

*Para poder procesar el pedido es **imprescindible** enviar a Ortoibérica este formulario y:*

☐ *Archivo escaneado 3D del calergo (.stl)* *(Marcar documentación aportada ☒)*

☐ *3 fotografías centradas del paciente, bien posicionado, sobre el calergo:*

☐ *1- lateral izquierda,* ☐ *2- lateral derecha,* ☐ *3- frontal.*

Las medidas y datos escritos en este formulario son responsabilidad exclusiva del solicitante, quien será el fabricante del producto final.

Ortoibérica solamente ofrece productos y servicios subcontratados para dicha fabricación y determinará si la información aportada es suficiente para ello.

ORTOPEDIA

Nombre:_____ Nº Licencia Sanitaria:_____ País/ciudad:_____

Técnico:_____ Teléfono:_____ e-mail_____

SERVICIO/S SOLICITADO/S

☐ Nivel-1
Rectificado 3D

☐ Nivel 0
Espuma flexible:
☐ Blanca- *Soft*
☐ Amarilla- *Hard*
☐ Gris *X-Hard*

☐ Nivel +1
Fresado de espuma (Fabricación)
☐ Asiento ☐ Cojín ☐ Respaldo

☐ Nivel +2
Funda textil extraíble
☐ 1ª funda ☐ 2ª (Opcional)

☐ Nivel +3
Carcasa aluminio

DATOS DEL PACIENTE

Código o Nombre: _____ Edad:_____ Peso:_____Kg ☐ ♀ ☐ ♂

MEDIDAS (mm): ASIENTO PACIENTE

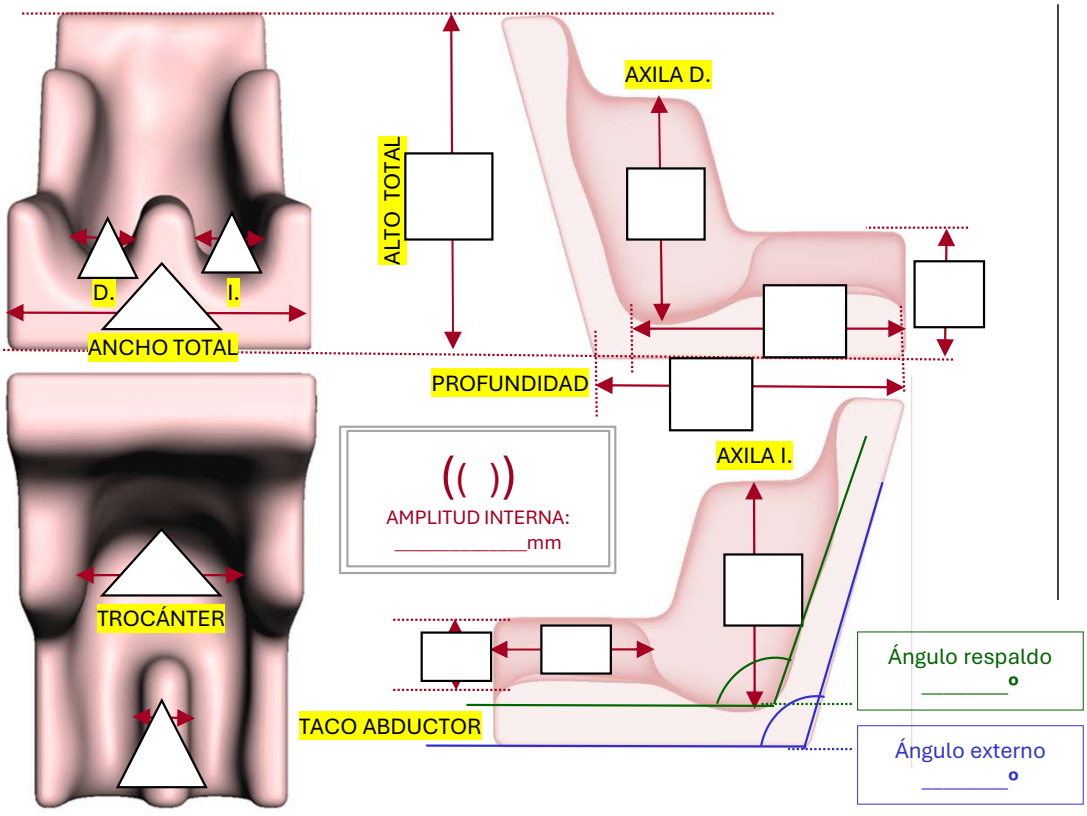

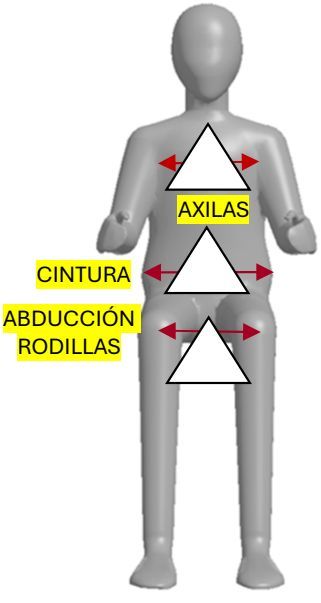

Si no se cubren algunos campos, se respetarán las MEDIDAS y FORMA que aparezcan en el archivo escaneado.

Fecha:_____/_____/_____

Firmado:

Epsilon para: “Gepetto Mousse 3D”

ORTOIBÉRICA S.L.
Parque Tecnológico de Asturias – Parc. 1
33428 – Llanera –Asturias (España)
T:+34 985 79 48 00
welcome@ortoiberica.es
www.ORtoiberica.com

Otros datos necesarios para el diseño.

Es necesario cubrir estos campos del formulario. En caso contrario, quedará a criterio de Ortoibérica la posibilidad de no realizar el trabajo o hacer el diseño del asiento respetando la FORMA que aparezca en el archivo escaneado, sin asumir las consecuencias de su correcta adaptación al paciente.

Si no se marcan las combinaciones de durezas y densidad de la espuma en el GRÁFICO, Ortoibérica fresará toda la pieza en una sola densidad, que será en espuma amarilla, salvo que se seleccione otro color, sin asumir las consecuencias de adaptación de la densidad al paciente.

CORRECCIÓN SOBRE ARCHIVO ESCANEADO:

Tronco

☐ Mantener alineación ***(Std)***

☐ Corregir: _____º



Pelvis

☐ Mantener alineación ***(Std)***

☐ Corregir: _____

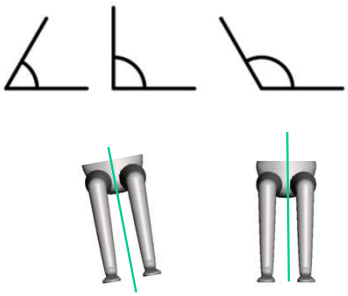

Piernas

☐ Mantener alineación ***(Std)***

☐ Corregir: _____º

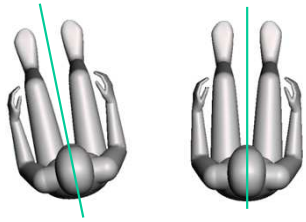

Reposacabezas

☐ 1- Integrado en asiento ***(Std)***

☐ 2- Sin reposacabezas.

☐ 3- Independiente.

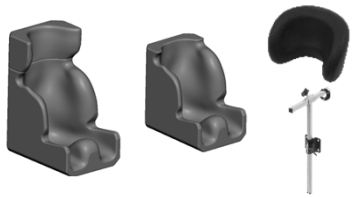

1 2 3

DUREZAS Y DENSIDAD DE LA ESPUMA: COMBINACIÓN

Si desea combinar espumas de diferente dureza, marcar sobre el **Gráfico A** el número correspondiente al tipo de material requerido.
Si desea hacer un inserto en material Visco (nº 4), dibujar su contorno en el **Gráfico B**

	Color	Densidad	Dureza (Cv40%) KPa
1-	Blanco	40 kg/m3	5,8 kPa
2-	*Amarillo* ***(Std)***	30 kg/m3	7,0 kPa
3-	Gris	60 kg/m3	20 kPa

4- Inserto ***Viscoelástico*** en zonas de mayor presión

Gráfico A

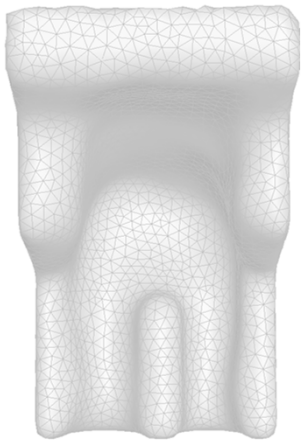

Gráfico B

OTROS COMPLEMENTOS

Cover con material impermeable:

(Pruwiatex Black)

☐ 1- En todo el asiento

☐ 2- Sólo en el cojín



1 2

Carcasa a medida:

(Material plástico)

☐ 1- ABS negro ☐ 4 ☐ 5 mm

☐ 2- *Naturplast* blanco ☐ 8 ☐ 10 ☐ 12 mm

1 2

Arnés 4 puntos:

(Textil impermeable)

☐ 1- Hombre ☐ S ☐ M ☐ L

☐ 2- Mujer: ☐ S ☐ M ☐ L

1 2